

ERRATA 01

Referente à Cotação Prévia de Preços nº 033/2022

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamento médico hospitalar permanente para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, conforme item especificado no Anexo I, deste documento.

Item: 01

Quantidade: 01

Unidade de medida: UN

Nome: Aspirador Ultrassônico para Neurocirurgia de Tumores

Valor Máximo Unitário: R\$ 316.800,00

Valor Total: R\$ 316.800,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Equipamento eletrônico microprocessado, incluindo carro com rodízios sendo 2 com travas, composto por: Painel resistente a respingos com mostradores digitais, com ajustes e seleções de intensidade para ultrassom, aspiração e irrigação; Com bomba de irrigação e de sucção simultâneos; com sistema de alarme sonoro e visual para indicação de falhas; Que permita utilização para remoção segura de tumores e dissecação óssea de crânio e coluna vertebral; Que contenha pedal para acionamento das peças de mão; Com no mínimo 2 (duas) Peças de mão com transdutor piezoelétrico de 25 KHz para Aspiração e para Dissecação óssea. Com 2 (duas) caixas de esterilização para as peças de mão contendo 2 chaves de torque em cada e 1 fio de limpeza em cada; Com no mínimo 25 (Vinte e cinco) ponteiros para aspiração de tecidos moles ou fibrosos e para dissecação óssea; Tensão elétrica 220V; Com no mínimo 25 (Vinte e cinco) unidades estéreis de sistema de irrigação e aspiração; Com no mínimo 02 (dois) reservatórios reutilizáveis para resíduos; Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação; Assistência técnica autorizada estabelecida na Região Sul; Registro vigente na Anvisa

LEIA-SE:

Item: 01

Quantidade: 01

Unidade de medida: UN

Nome: Aspirador Ultrassônico para Neurocirurgia de Tumores

Valor Máximo Unitário: R\$ 316.800,00


Valor Total: R\$ 316.800,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 01 (um) Aspirador Dissector Ultrassônico para Neurocirurgia de Tumores, com 01 peça de mão e demais complementos necessários. Equipamento eletrônico microprocessado, incluindo carro com rodízios sendo no mínimo 02 com travas para o Console do referido equipamento, composto por: Painel resistente a respingos com mostradores digitais, com



ajustes e seleções de intensidade para ultrassom, aspiração e irrigação; Com bomba de irrigação e de sucção simultâneos; com sistema de alarme sonoro e visual para indicação de falhas; Que permita utilização para remoção segura de tumores e dissecação óssea; Que contenha pedal para acionamento das peças de mão; Com no mínimo 1 (uma) Peça de mão com transdutor piezoelétrico de 25 KHz para Aspiração e para Dissecação óssea, autolavável a vapor. Com 1 (uma) caixa de esterilização original do mesmo fabricante para a peça de mão contendo 1 chave de torque e 1 fio de limpeza; Com no mínimo 25 (vinte e cinco) ponteiros para aspiração de tecidos moles ou fibrosos e para dissecação óssea; Tensão elétrica 220V; Com no mínimo 30 (trinta) conjuntos de tubos originais descartáveis originais do próprio fabricante; Com no mínimo 24 (vinte e quatro) reservatórios para resíduos; E todos os demais itens necessários ao funcionamento operacional do equipamento; Com custos de fretes, instalação e treinamento por conta do fornecedor; Garantia de 24 meses contra defeitos de fabricação; Assistência técnica autorizada no Paraná; Registro vigente na Anvisa; Prazo de entrega limite: 90 dias;

Guarapuava, 18 de Agosto de 2022.

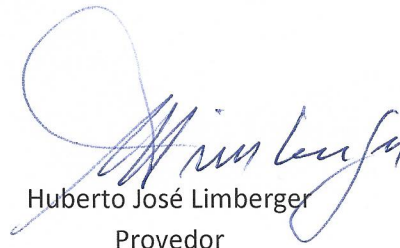

Huberto José Limberger
Provedor

